



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |


E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Rev. 16/12/2014

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

VETRINI PER MICROSCOPIA 
MICROSCOPE SLIDES

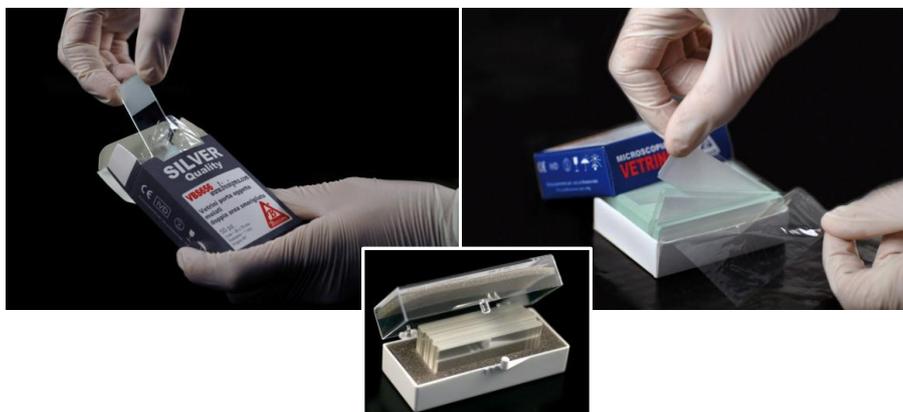

Codice CND W0503900201 VETRINI PORTAOGGETTO

Codice CND W0503900202 VETRINI COPRIOGGETTO

CONFORMI AGLI STANDARD INTERNAZIONALI ISO 8255-1 E ISO 8037-1
IN CONFORMITY WITH INTERNATIONAL STANDARDS AND ISO 8255-1 ISO 8037-1

REF	PORTAOGGETTO Durata 18 mesi - Dim. 26 x 76 mm spessore 1 ÷ 1,2 mm SLIDES Shelf Life 18 months - Dim. 26 x 76 mm - thickness 1 ÷ 1.2 mm	Conf.
VBS653/A	TAGLIATI / Cut Edges	50 x 50 pz
VBS654/A	TAGLIATI con DOPPIA AREA SMERIGLIATA / Cut edges with double frosted area	50 x 50 pz
VBS655/A	MOLATI / Ground edges	50 x 50 pz
SILVER QUALITY		
VBS653	TAGLIATI (senza cartina tra i singoli pezzi) / Cut edges (without paper between single pieces)	50 x 50 pz
VBS654	TAGLIATI con DOPPIA AREA SMERIGLIATA / Cut edges double frosted area (without paper between single pieces)	50 x 50 pz
VBS655	MOLATI (senza cartina tra i singoli pezzi) / Ground edges double frosted area (without paper between single pieces)	50 x 50 pz
VBS656	MOLATI con DOPPIA AREA SMERIGLIATA / Ground edges double frosted area (without paper between single pieces)	50 x 50 pz

REF	VETRINI COPRIOGGETTO Durata 15 mesi - spessore 0,13 ÷ 0,17 mm COVER GLASS - Shelf Life 15 months - thickness 0.13 ÷ 0.17 mm	Conf.
VBS633	18 X 18 mm	10 x 200 pz
VBS6331	18 X 24 mm	5 x 200 pz
VBS634	20 x 20 mm	10 x 200 pz
VBS636	22 x 22 mm	10 x 200 pz
VBS637	24 x 24 mm	10 x 200 pz
VBS638	24 x 32 mm	10 x 100 pz
VBS649	24 x 40 mm	10 x 100 pz
VBS650	24 x 50 mm	10 x 100 pz
VBS651	24 x 60 mm	10 x 100 pz



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Rev. 16/12/2014

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO

Destinato esclusivamente ad uso professionale

RACCOMANDAZIONI D'USO (a carattere esclusivamente informativo)

- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio
 - Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare
 - Non variare la destinazione d'uso
 - Prodotto non adatto ai bambini
 - Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole
 - Smaltimento: utilizzare gli appositi d.p.i e smaltire secondo la normativa vigente
 - I Vetrini portaoggetto e coprioggetto sono particolarmente indicati per l'analisi microscopica di sangue, urina e campioni di tessuti.
- I vetrini portaoggetti e coprioggetto sono pronti per l'uso e non devono essere riutilizzati.
- Ogni confezione è protetta dall'umidità grazie ad un film di cellophane (portaoggetto) o in alluminio (coprioggetto) e alla presenza di un agente disidratante all'interno della confezione stessa.
- Fare attenzione alla possibilità di ferirsi mentre si maneggiano vetrini portaoggetto e coprioggetto, e prendere le adeguate misure di sicurezza, per esempio indossare i guanti.
- Stoccaggio:
 - Tenere asciutti
 - Evitare elevati sbalzi di temperatura sia durante lo stoccaggio che durante l'utilizzo. La refrigerazione del prodotto può causare condensazione e portare l'acqua di condensa tra i vetrini
 - Proteggere il fondo del cartone dall'umidità
 - Periodo di stoccaggio : vedere data di scadenza

IN VITRO MEDICAL DIAGNOSTIC DEVICE

Only for professional use

USE RECOMMENDATIONS (only for information)

- Use only for laboratory analysis,
 - Use gloves: contamination risk if contents leaks,
 - Keep out of flame or heat sources which might damage the product,
 - Do not vary the intended purpose of the product,
 - Do not use after expiry date,
 - Keep out of reach of children,
 - Keep in a dry place, far from sources of heat and from direct sunlight,
 - Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations,
 - Microscope slides and cover glass are particularly indicated for microscope analysis of blood, urine and tissue samples
- Microscope slides and cover glass are ready to use and mustn't be reused.
- Each pack is protected from moisture thanks to a cellophane film (specimen) or aluminum (coverslip) and the presence of a dehydrating agent inside the package
- To pay attention to the possibility to hurt yourself while handling microscope slides and cover glass, take the adequate measures of emergency, as an example to wear the gloves.
- Storage:
 - Keep Dry,
 - Avoid high change in temperature also during storage and using. The refrigeration of product may cause condensation and water condenses between slides,
 - Keep away the carton bottom from humidity,
 - Time of storage : see expiry date.

DESTINAZIONE D'USO

I VETRINI sono prodotti monouso destinati all'analisi microscopica di sangue, urina, campioni di tessuti e altri campioni biologici ai fini di un esame diagnostico in vitro.

APPLICAZIONI: Anatomia patologica

ESCLUSIVAMENTE PER USO IN VITRO.

Per uso esclusivamente professionale.

INTENDED USE

SLIDES are disposable products for microscopic analysis of blood, urine, tissue samples and other biological samples for the purpose of in vitro diagnostic examination.

APPLICATIONS: Pathology

USE ONLY IN VITRO.

For professional use only.



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Rev. 16/12/2014

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

MATERIALI / MATERIAL

I vetrini per microscopia sono prodotti in vetro sodico-calcico di alta qualità.

Microscope slides are made by high quality soda-lime glass .

Composizione chimica (%) / Chemical composition (%):

72,00 %	SiO ₂	Ossido di Silicio / <i>Silicon Oxide</i>
14,50 %	Na ₂ O	Ossido di Sodio / <i>Sodium Oxide</i>
7,05 %	CaO	Ossido di Calcio / <i>Calcium Oxide</i>
1,65 %	Al ₂ O ₃	Ossido di Alluminio / <i>Aluminium Oxide</i>
3,95 %	MgO	Ossido di Magnesio / <i>Magnesium Oxide</i>
0,30 %	K ₂ O	Ossido di Potassio / <i>Potassium Oxide</i>
0,06 %	Fe ₂ O ₃	Ossido di Ferro / <i>Iron Oxide</i>
Densità / Density :		2.50 x 103 kg/m³

SPECIFICHE TECNICHE

VETRINI PORTAOGGETTO

Durata 18 mesi

Dimensioni: ca. 26 x 76 x 1,0-1,2 mm

Vetro: trasparente

Tolleranza spessore: 1,1 +- 0,1 mm

VETRINI COPRIOGGETTO

Durata: 15 mesi

Spessore: 0,13 ÷ 0,17 mm

Indice di rifrazione: 1.53

Vetro: trasparente

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MICROSCOPE SLIDES

Shelf life 18 months

Dimensions: ca. 26 x 76 x 1.0-1.2 mm

Glass: Transparent

Thickness tolerances: 1.1 +- 0.1 mm

COVER GLASS

Shelf life: 15 months

Thickness: 0.13 ÷ 0.17 mm

Refractive index: 1.53

Glass: Transparent

DEFINIZIONE DEL FABBRICANTE/ MANUFACTURER DEFINITION

BIOSIGMA s.r.l.

Via Valletta, 6 - 30010 - Cantarana di Cona (VE) - ITALY

Tel. +39.0426.302224 - Fax +39.0426.302228

E-mail: info@biosigma.com - <http://www.biosigma.com>

CLASSIFICAZIONE

Ai fini della Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro recepita in Italia con D.L. n. 332, G.U.R.I. n. 269 del 17 novembre 2000, Biosigma S.r.l. definisce tutti i componenti di suddetta famiglia come dispositivi medico-diagnostici in vitro e li classifica come "Altri dispositivi medico-diagnostici in vitro", quindi da rendere conformi all'allegato III della direttiva.

La Dichiarazione di conformità alla **Direttiva 98/79/CE** relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro è disponibile, su richiesta, presso l'Ufficio Qualità Biosigma S.r.l.

CLASSIFICATION

In order to the Directive 98/79/CE concerning medical-diagnostic in vitro devices receipt in Italy with D.L. n. 332 G.U.R.I. n. 269 dated 17 November 2000, Biosigma s.r.l., defines all the components of the above-state family as medical-diagnostic in vitro devices and it classifies as "Other medical-diagnostic in vitro devices", in order to make conformable the attachment III of the directive.

*The Declaration of Conformity in accordance to the **Direttiva 98/79/CE** is available, on request, to the Quality Department Biosigma S.r.l.*



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Rev. 16/12/2014

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

Interpretazione dei simboli sull'imballaggio/ Interpretation of the symbols on the package

	Questo prodotto è conforme alla Direttiva 98/79/CE sui Dispositivi Medico Diagnostici In Vitro <i>This product fulfils the requirements of Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices</i>		Simbolo per "Mantenere secco" <i>Symbol for "Keep dry"</i>
	Simbolo per "non riutilizzare" <i>Symbol for "Do not reuse"</i>		Simbolo per "codice del lotto" <i>Symbol for "batch code"</i>
	Simbolo per "Consultare le istruzioni per l'uso" <i>Symbol for "Consult Instructions for Use"</i>		Simbolo per "utilizzare entro" <i>Symbol for "Use by"</i>
	Simbolo per "limite di temperatura" <i>Symbol for "temperature limitation"</i>		Simbolo per "fabbricante" <i>Symbol for "Manufacturer"</i>
	Simbolo per "Dispositivo Medico-Diagnostico In Vitro" <i>Symbol for "In Vitro Diagnostic Medical Device"</i>		Simbolo per "Fragile, maneggiare con cura" <i>Symbol for "Fragile, handle with care"</i>
	Simbolo per "Metodo di sterilizzazione con radiazioni ionizzanti" <i>Symbol for "Method of sterilization using irradiation"</i>		Simbolo per "Metodo di sterilizzazione con ossido di etilene" <i>Symbol for "Method of sterilization using ethylene oxide"</i>
	Simbolo per "Non utilizzare se la confezione è danneggiata" <i>Symbol for "Do not use if package damaged"</i>		Simbolo per "Tenere lontano dal calore" <i>Symbol for "Keep away from heat"</i>